




DIACARTA™

QUANTI DNA™


SICURO ED EFFICACE NEL TRIAGE DI PAZIENTI FIT+

► SICURO

Non inferiore allo Standard of Care nell'individuazione di lesioni significative

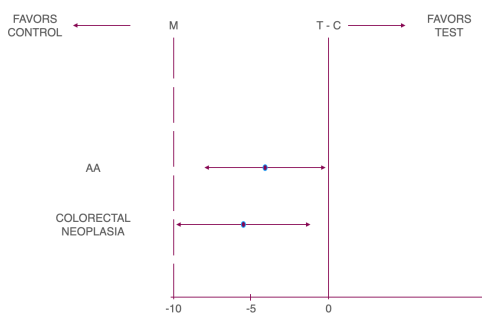

Il valore centrale e il 95% C.I. per AA, CCR e CN completamente entro il margine (conferma non-inferiorità)

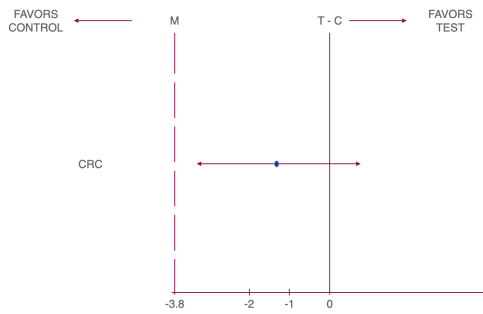

Il limite superiore del 95% C.I. per CCR attraversa la linea di differenza 0, indicando una possibile superiorità.

► EFFICACE

Potenziale riduzione del 33,4% delle colonoscopie

► SEMPLICE PRELIEVO DEL CAMPIONE

2 ml di sangue intero

► TECNOLOGIA DI LABORATORIO SEMPLICE E AFFERMATA



Amplificazione del segnale, estrazione DNA non necessaria



DIACARTA™


KIT QUANTIDNA™ DNA MEASUREMENT ASSAY

CODICE PRODOTTO: DC-08-0092E

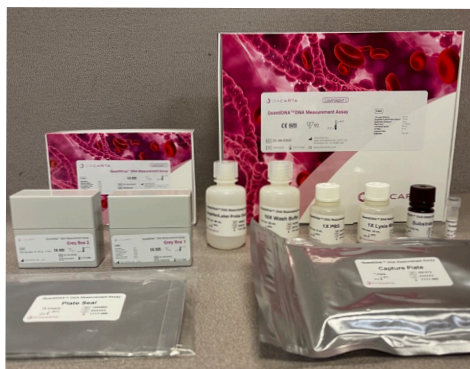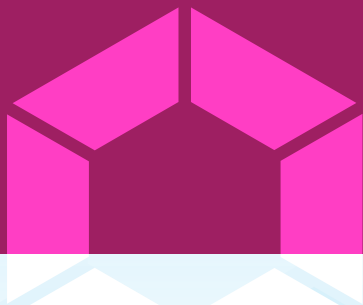


DIACARTA LUMINOMETER

CODICE PRODOTTO: DC-06-0001E

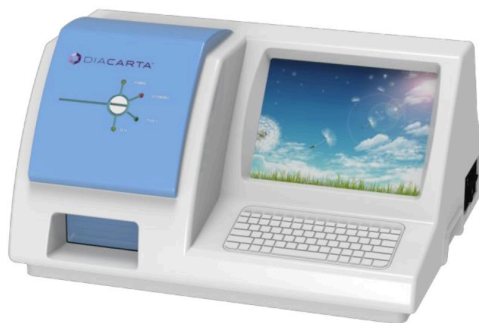

WORKFLOW

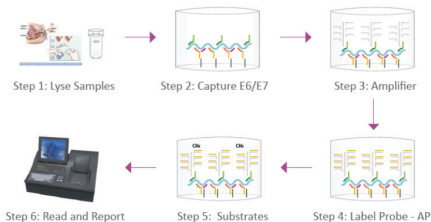

Per informazioni ed ordini, rivolgersi a ufficioordini@elettrobiochimica.com

 DIACARTA™

www.diacarta.com

sscimia@diacarta.com